


EV5.15 - Mise à jour des fournitures SESAM VITAL

Durée d'intervention : 5 minutes


Pré-requis : RAS

Gestes opérationnels :

1. Depuis ExpressVitalité, cliquez sur Informations (1), puis sur SESAM-Vitalité (2) et enfin patienter un peu que le bouton « Mettre à jour » (3) apparaisse. Si ce dernier n'apparaît pas, ça signifie que votre ordinateur est déjà à jour. S'il apparaît, cliquez dessus et laissez vous guider.

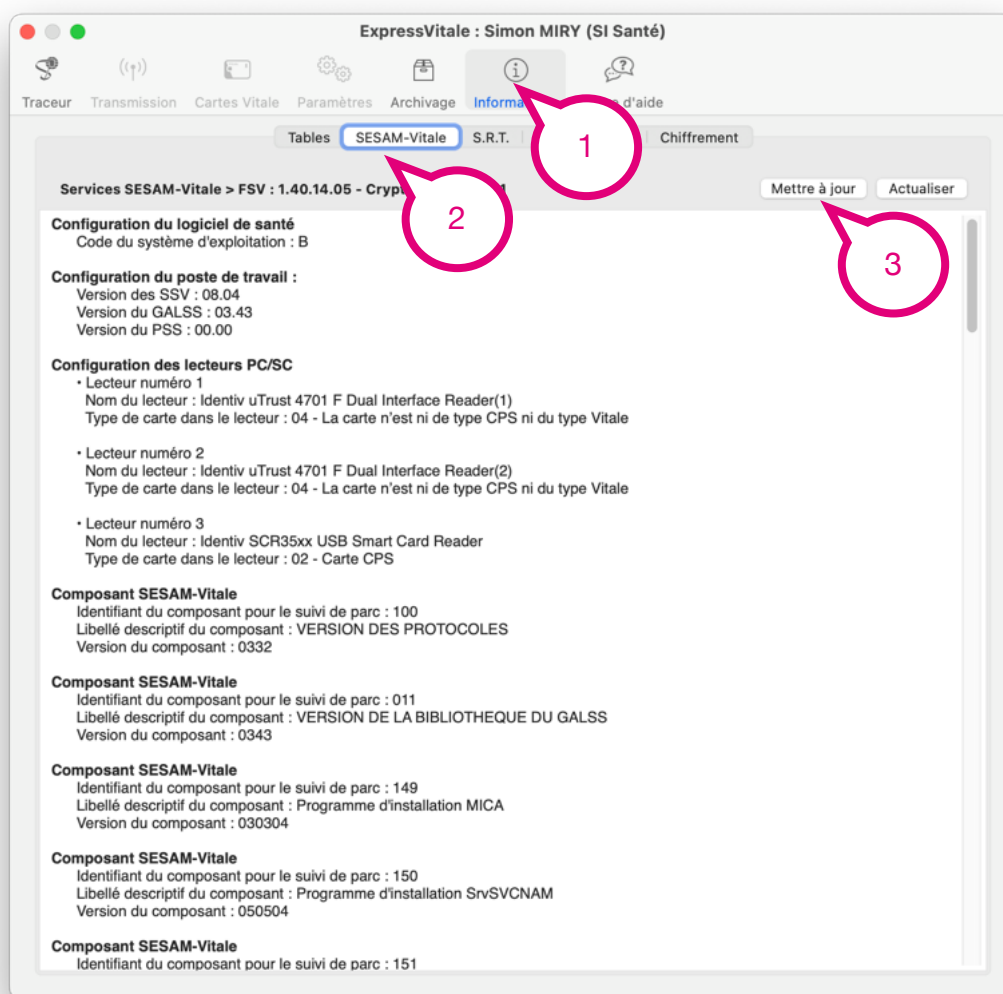

- Depuis le logiciel DiagAM présent dans le répertoire Applications du Mac, cliquez sur « Diagnostic Technique » (4). Si vous voyez des versions plus récentes des logiciels SrvSVCNAM et/ou Cryptolib CPS (cf. Point n°5), installez les.

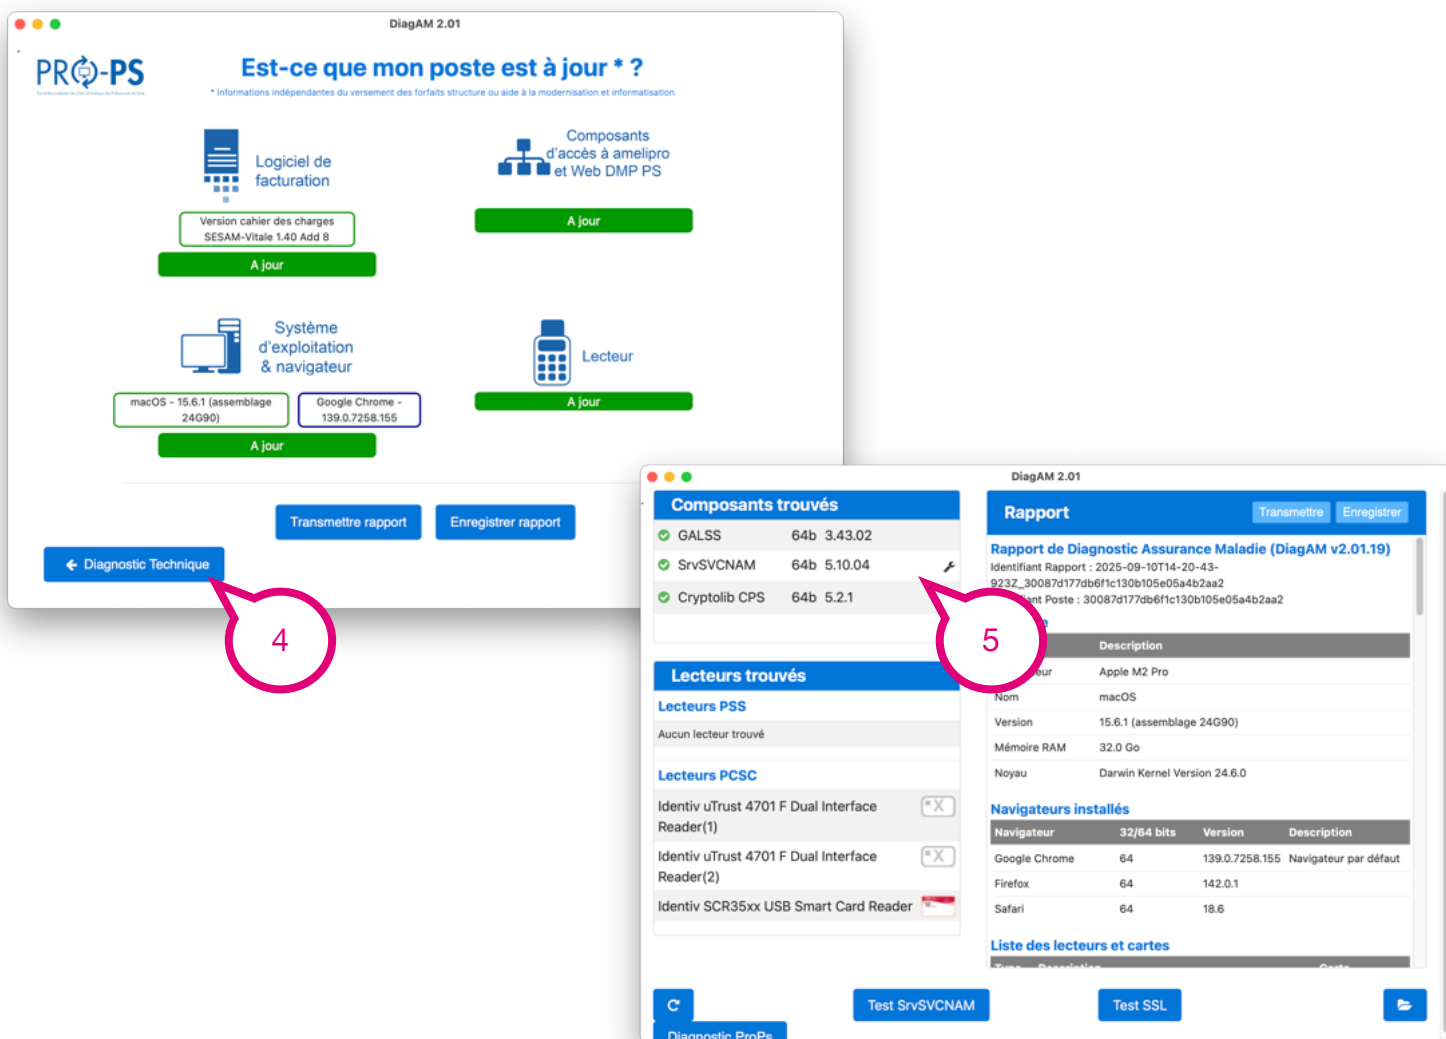

Fin de l'intervention